

Certificazione di efficienza

Oggetto : produzione di ozono da parte del reattore OZSY. H150 – 8 reattori - della ditta STIA srl. di Milano

La misura è stata effettuata mediante lo strumento della ditta In-USA tipo SCI-MUX collegato alla sonda GFFOZ della ditta stessa e tarato secondo manuale operativo il 4 agosto 2005

Misure effettuate in data Giovedì 4 Agosto 2005
presso la sede di Ecologia Applicata srl. di Busto Arsizio

Portata aria l/min	Produzione Ozono g/m ³
4.0000	47.5000
5.0000	40.7000
6.0000	38.3000
7.0000	35.2000
8.0000	32.1000
9.0000	30.0000
10.0000	27.6000
11.0000	26.2000
12.0000	25.2000
13.0000	24.2000
14.0000	23.1000
15.0000	22.3000

Ecologia Applicata S.r.l.

Via Porpora, 9
20131 Milano - Italy


Phone: (+39) 02 2895978
Fax: (+39) 02 2871159

Numero Anagrafe Nazionale delle Ricerche: 602910X9

N. Reg. Soc.2876/7334/26/MI
N. Reg. Ditte 1294361
Part.IVA 09453070154

E-mail: info@ecologia-applicata.it
ecologia-applicata@iol.it

Produzione Ozono - OZSY.H150 - 8 reattori

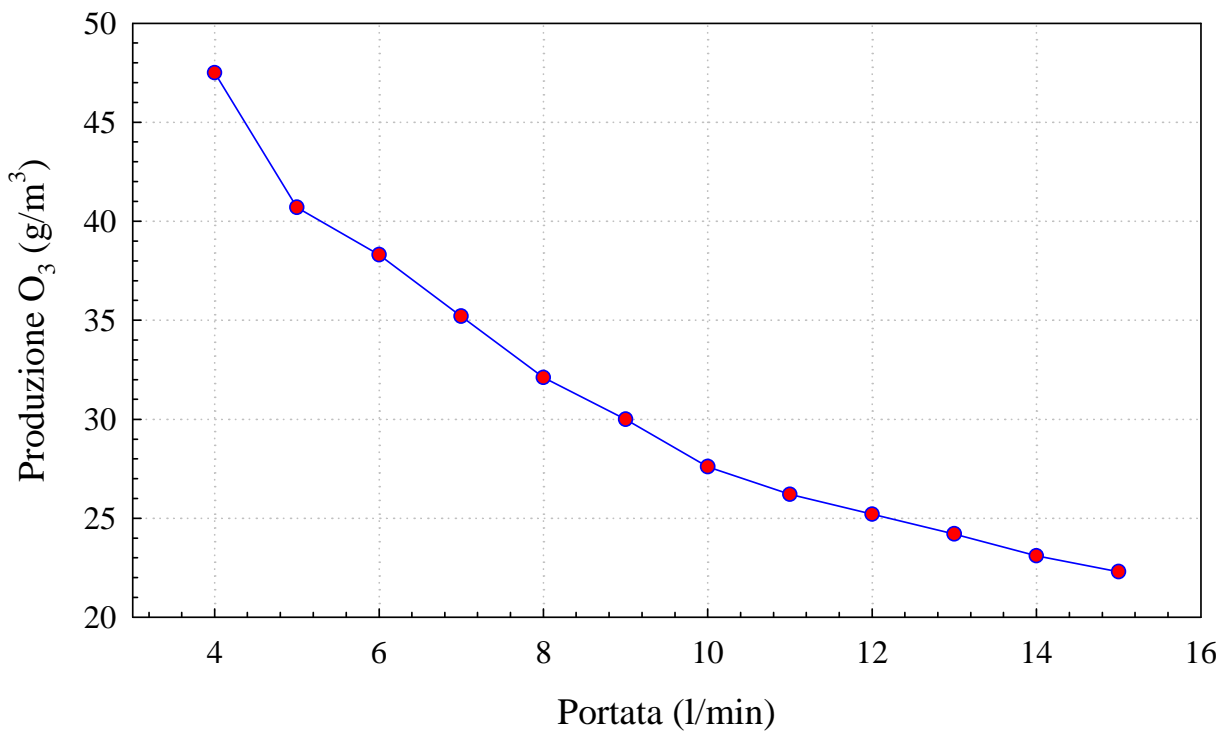

Note:

- La misura riportata rappresenta quella realizzata circa 40 min dopo l'accensione e l'azzeramento dello strumento. I valori misurati pochi minuti dopo l'accensione risultano sensibilmente più elevati.

Milano 4 agosto 2005

Il Direttore Scientifico

Dr. Paolo Broglio

Ecologia Applicata S.r.l.

Via Porpora, 9
20131 Milano - Italy

Phone: (+39) 02 2895978
Fax: (+39) 02 2871159

Numero Anagrafe Nazionale delle Ricerche: 602910X9

N. Reg. Soc. 2876/7334/26/MI

N. Reg. Ditte 1294361

Part. IVA 09453070154

E-mail: info@ecologia-applicata.it
ecologia-applicata@iol.it